

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet**  
(9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.)  
bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000  
adószáma: 15367307-2-08,  
képviselésében eljár **Dr. Benedek Zoltán főigazgató,**  
továbbiakban mint **Vevő,**

másrészről

neve: ALLEGRO Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.  
székhelye: 1045 Budapest, Berliini utca 47-49.  
cégjegyzék száma: 01-09-167930  
bankszámla száma: 10300002-20208217-00003285  
adószáma: 10361863-2-41  
képviselésében eljár: Kovács Éva ügyvezető  
továbbiakban mint **Eladó**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

### **1. A szerződés tárgya, mennyisége**

A szerződés tárgya:

- 1.1. 10 db Steripower típusú szenzoros kézfertőtlenítő berendezés beszerzése.
- 1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében kizárólag új termék szállítható. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés keretében általa kiszállítandó termék megfelel a vonatkozó szabványoknak és a törvényben és a törvényhez kapcsolódó hatályos rendeletekben foglaltaknak. Az Eladó kifogástalan minőségű termék szállítására köteles. Eladó tudomásul veszi, hogy mindezekért a Ptk-ban foglalt szabályok szerint szavatossági és kárfelelősséggel tartozik.
- 1.3. Jelen szerződés aláírásával Vevő megrendeli, az Eladó kötelezettséget vállal az 1.1. pontban írt termékek szállítására.

### **2. A szerződés időtartama**

- 2.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1.1 pontban részletezett termékek leszállításának határideje 6 hét, jelen szerződés hatályba lépésétől számítva.
- 2.2. Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő az előteljesítéshez hozzájárulását adja. Eladó köteles a Vevőt a teljesítés idejéről 3 munkanappal korábban értesíteni.

### **3. A teljesítés helye**

- 3.1. Jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott termékeket Eladó az alábbi helyszínre köteles leszállítani:  
9330-Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 10.

### **4. Fizetési feltételek**

- 4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítés ellenértékeként 993.600 Ft + 27 % ÁFA, azaz 1.261.872 Ft, amely magában foglalja a termékek jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott helyszínre történő kiszállításának a költségét is. Az ellenérték semmilyen jogcímen nem módosítható.
- 4.2. A Szerződés és a kifizetés pénzneme Forint (HUF).
- 4.3. Vevő előleget nem fizet.
- 4.4. Vevő a teljesítés ellenértékét utólag, az Eladó – szerződésnek és jogszabályoknak megfelelően kiállított – számlája Vevő általi kézhezvételének napját követően a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint banki átutalással egyenlíti ki.

- 4.5. A kifizetés határideje a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 nap.
- 4.6. Jelen szerződés teljesítése során az Art 36/A. § rendelkezései irányadóak.
- 4.7. Eladó a jelen pontban rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéken nem érvényesíthet, amely a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik. A benyújtott számla kötelező melléklete a Vevő által kiadott teljesítésigazolás.
- 4.8. Eladót a Vevő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:186. § (4) bekezdésében rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.

#### **5. Az Eladó jogai és kötelezettségei**

- 5.1. Eladó köteles a szállított eszközökhöz magyar nyelvű használati, kezelési útmutatót csatolni.
- 5.2. Eladó a leszállított termékek vonatkozásában 12 hónap teljes körű jótállás nyújtására köteles.

#### **6. Szerződés hatályba lépése és felmondása**

- 6.1. Jelen szerződés a szerződő felek általi aláírással lép hatályba. Ezen szerződés a teljesítéssel szűnik meg.
- 6.2. A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor.  
A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.  
Azonnali hatályú felmondásnak minősül, ha
  - eladó késedelmesen teljesít;
  - eladó nem minősül átlátható szervezetnek.
- 6.3. Eladó kijelenti, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a szerződés időtartama alatt eladó elveszíti átláthatóságát, úgy az felmondási oknak minősül (1. sz. melléklet).
- 6.4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban írt esetekben.

#### **7. Egyéb feltételek**

- 7.1. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: magyar.
- 7.2. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.
- 7.3. Jelen szerződés 4 példányban, magyar nyelven készült, melyből 2 példány az Eladót, 2 példány a Vevőt illeti.

**8. Eljáró bíróság, alkalmazott jog**

- 8.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérlik békés úton rendezni, annak eredménytelensége esetén alávetik magukat a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, a pertárgy értékétől függően.
- 8.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény).


**Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá.**


Kapuvár, 2016. december hó 29. nap

Megrendelő:

  
Dr. Benedek Zoltán  
főigazgató




  
Vámosné Áder Anna Mária  
gazdasági igazgató



**ALLEGRO** 2.  
Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.  
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.  
Telefon: 350-21-07. Telefax: 329-18-54  
MKB Rt.: 10300002-20203217-00003285  
Adószám: 10161803-0-01


Eladó:

  
Kovács Éva  
ügyvezető

Melléklet:

1. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
2. sz. melléklet: Magyar nyelvű termékismertető

**Pénzügyileg ellenjegyzem:**

  
.....  
Kapuvár, 2016. 12. 29.

## ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott Kovács Éva Zsuzsanna, mint az ALLEGRO KFT. (cég) (székhely:1045 Budapest, Berliini utca 47-49., cégjegyzékszám:01-09-167930 képviselője büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában

### **kijelentem**



hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismerem és ennek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy az **ALLEGRO KFT. (cég) átlátható szervezetnek minősül.**

Tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. – a továbbiakban: Áht. – 41.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, mint költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve már létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést.

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet felmondja, illetve ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet kezelje.



*Kelt: Budapest, 2016. december 29.*


  
.....  
  
.....  
cégszerű aláírás

 ALLEGRO




Steripower®

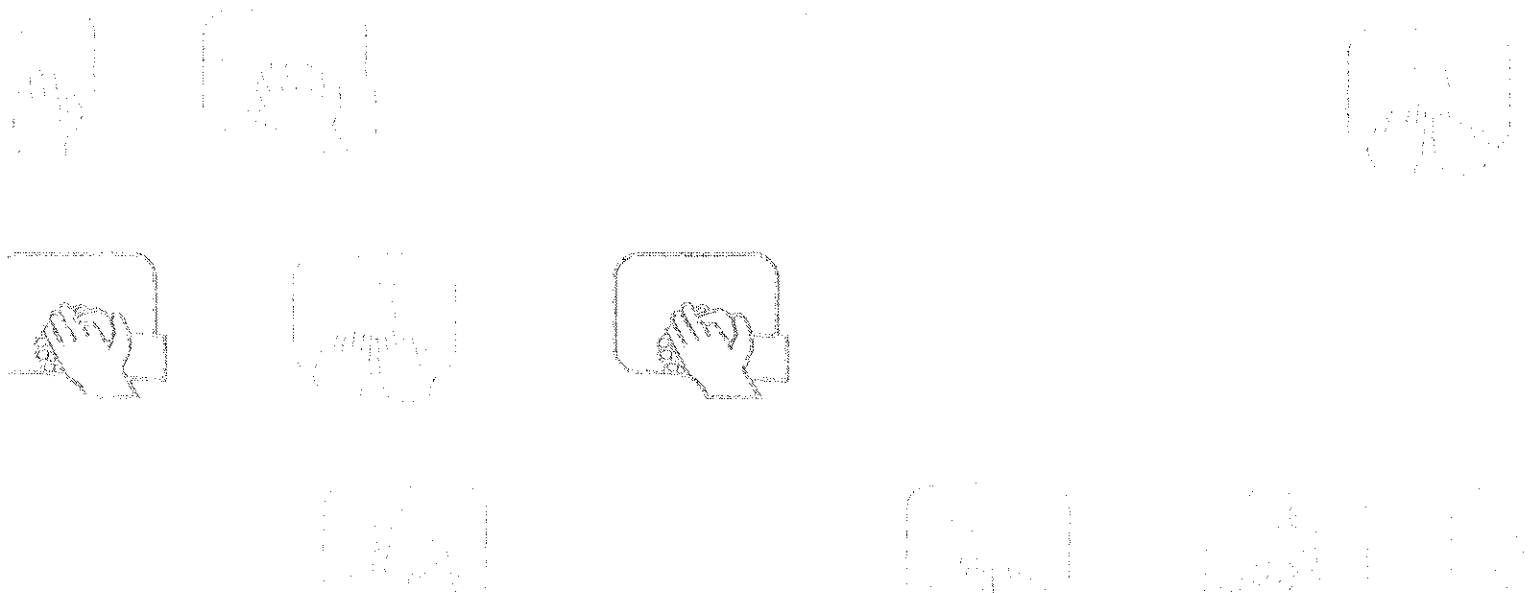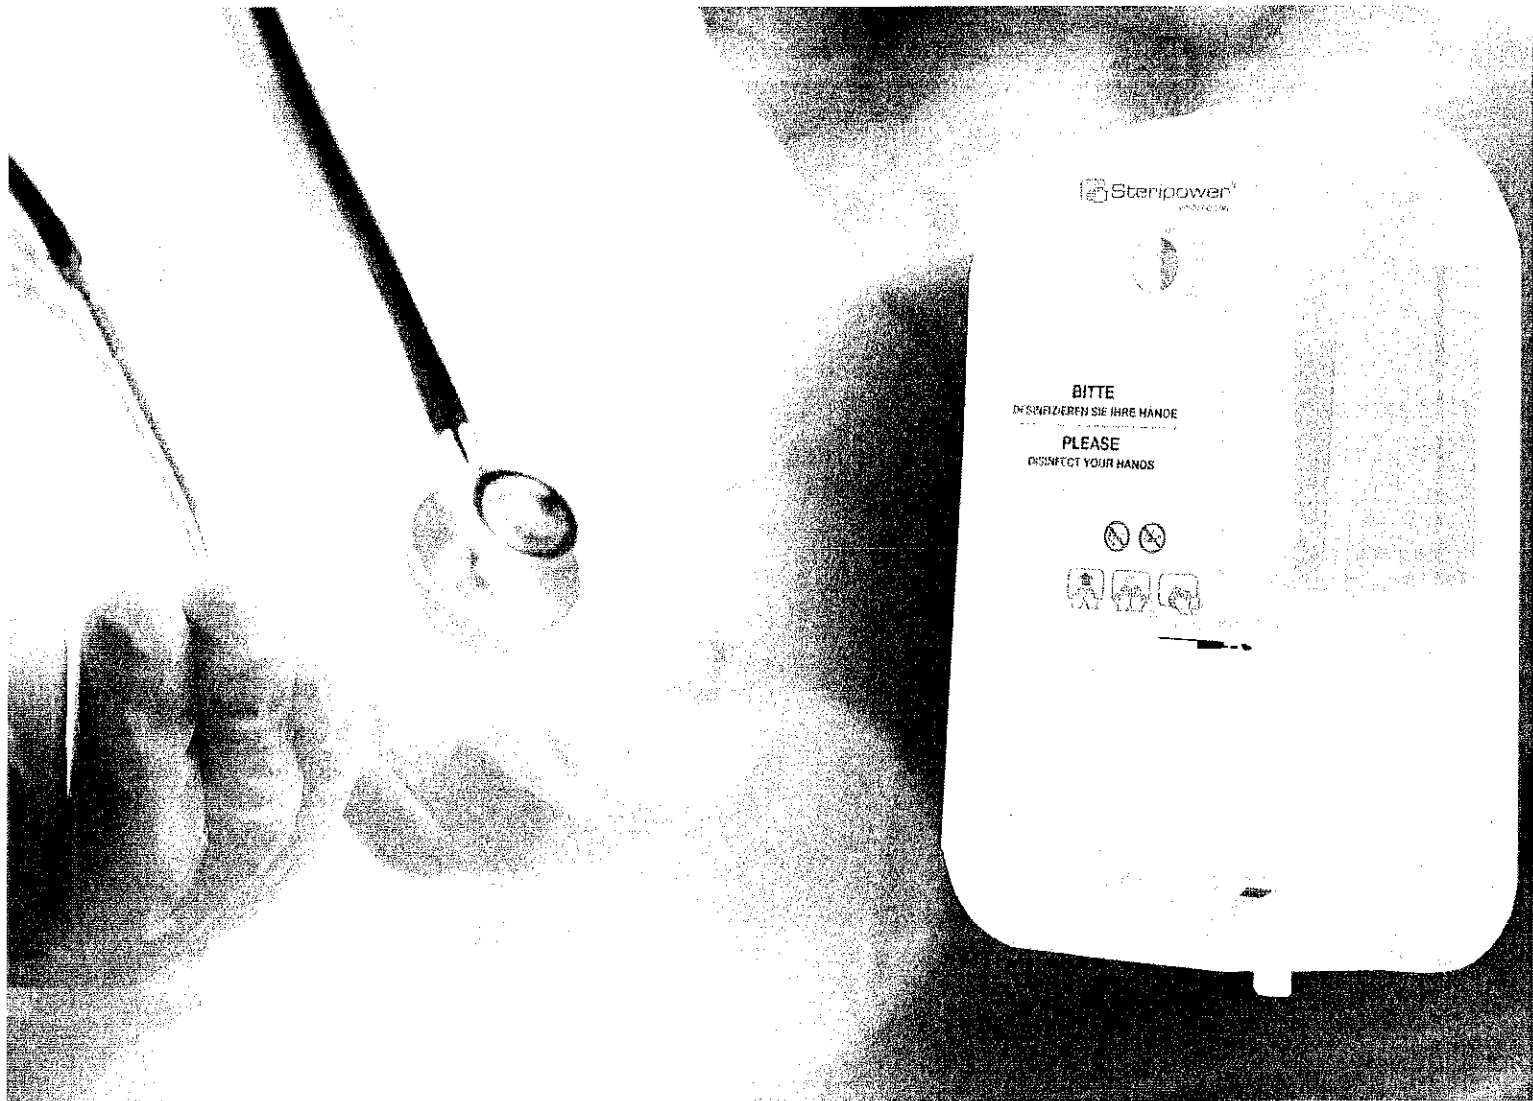

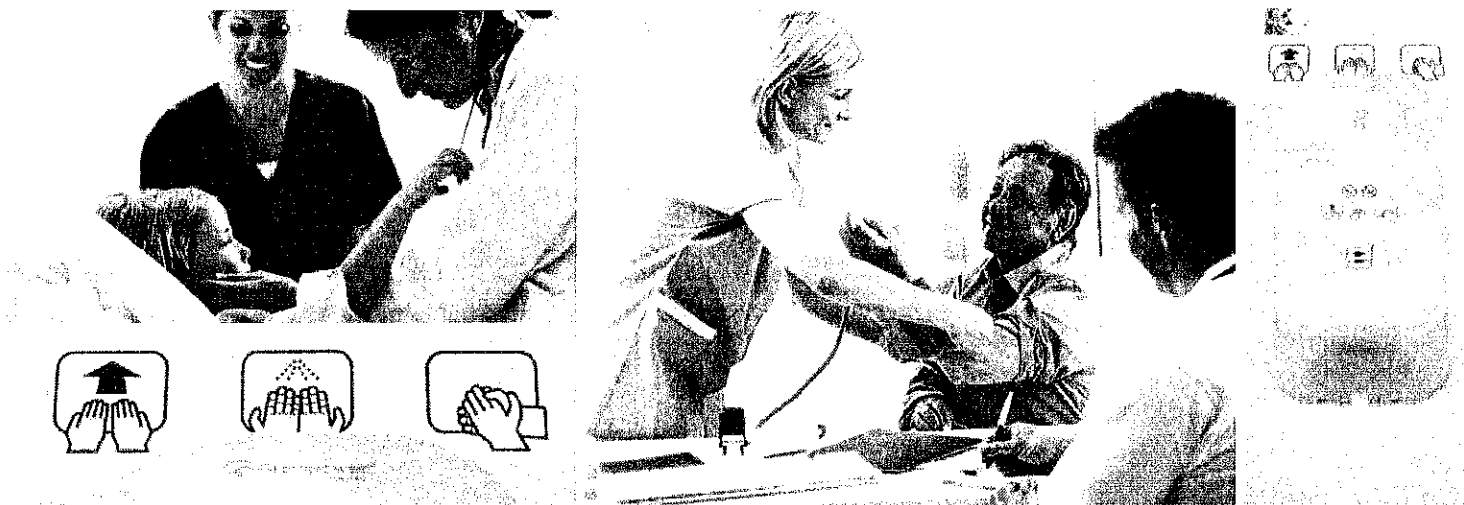

## STERIPOWER AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN

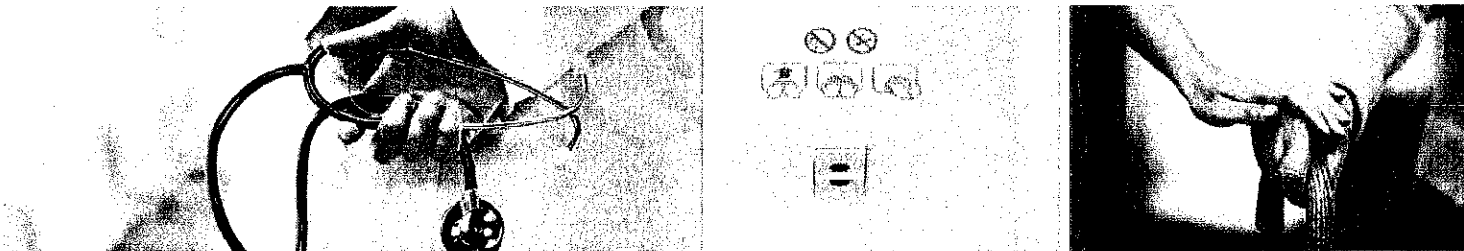

Az egészségügyi intézményeknek magasak a higiéniai elvárásaik. Az egészségügyi dolgozók a kulcs szereplői a kórokozók terjesztésének meggátolásában. Felismerték, hogy a megfelelő kézhigiénia hiánya az egyik fő okozója a kórházban szerzett fertőzéseknek és a multirezisztens organizmusok terjedésének.

Az egészségügyi dolgozók napi munkájának támogatásaként, kifejlesztettünk egy falra szerelhető rendszert érintésmentes fertőtlenítő készülékkel. A Steripower megfelelő a mindennapi használatra.

A Steripower kiemelt jellemzői az egészségügyi intézmények számára



- bármely fertőtlenítő oldattal kompatibilis
- ajtó nyitási funkció
- a fertőtlenítőszer neve és lejárati ideje látható az átlátszó borításnak köszönhetően (Steripower fehér)
- felhasználás számolható
- állítható adagolás (a fertőtlenítőszer adagolás állítható 0,5-5ml-ig)

**Steripower Special – Falra szerelhető rendszer monitorral**



- kollégák tájékoztatása hírekről
- betegek tájékoztatása a profilaxisról
- monitor használata hirdetési felületként

**Javaslatok Steripower készülékek használatáról egészségügyi intézményekben**

- |          |  |
|----------|--|
| PW-10040 | Steripower fehér, akkumulátorral                       |
| PW-10100 | Steripower fehér állandó áramellátással                |
| PW-10060 | Steripower rozsdamentes acélból, akkumulátorral        |
| PW-10061 | Steripower rozsdamentes acélból állandó áramellátással |

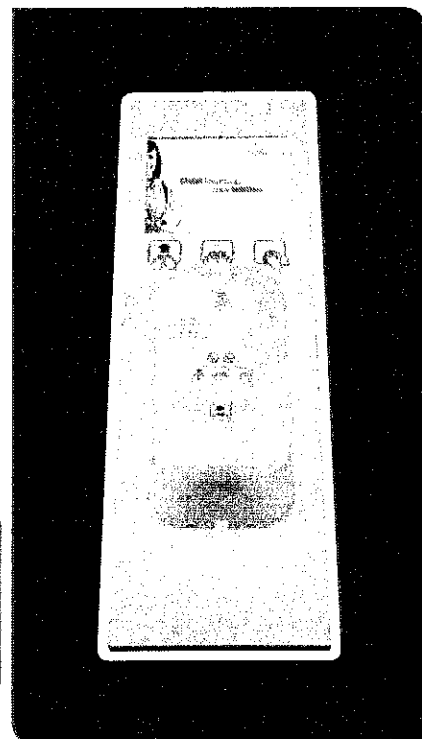

**schülke**

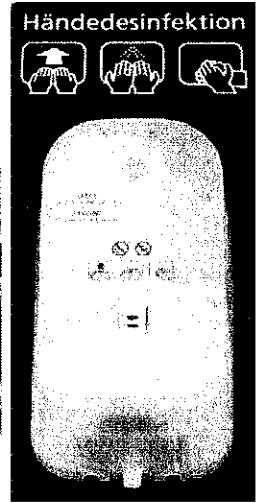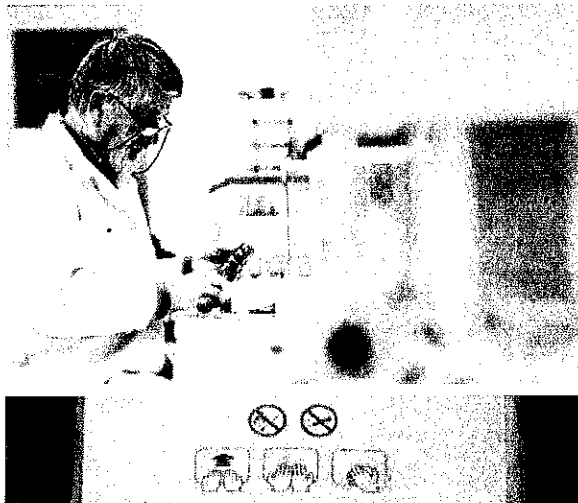

## STERIPOWER A LABORBAN





A laboratóriumoknak számtalan higiéniai szabályai léteznek. Kifejlesztettünk egy speciális tulajdonságot, ami közvetlenül összeköti a Steripower fertőtlenítő rendszert az ajtóval: Fertőtlenítőszer használatát követően kinyílik az ajtó. Ez segít növelni a higiéniai szabványokat.

A Steripower kiemelt jellemzői laboratóriumok számára


- felhasználás számolható
- Ajtó nyitó funkció
- állítható adagolás (a fertőtlenítőszer adagolás állítható 0,5-5ml-ig)
- bármely fertőtlenítő oldattal kompatibilis

Javaslatok Steripower készülékek használatáról laboratóriumokban

PW-10040	Steripower fehér, akkumulátorral
PW-10100	Steripower fehér állandó áramellátással
PW-10050	Steripower fehér, ajtó nyitó jelzéssel, akkumulátorral
PW-10110	Steripower fehér, ajtó nyitó jelzéssel, állandó áramellátással

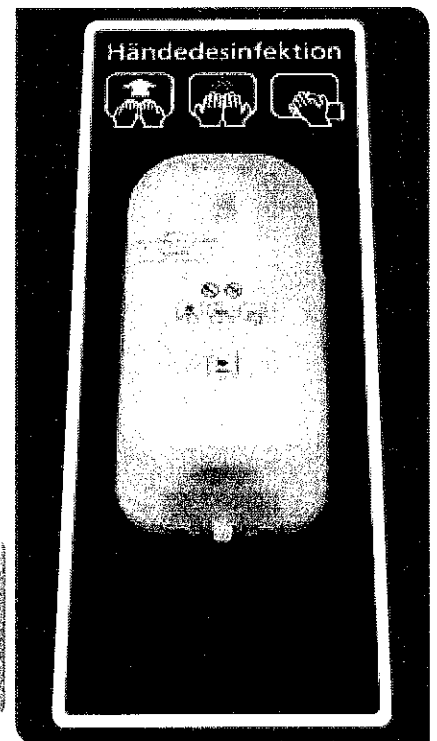

schülke →

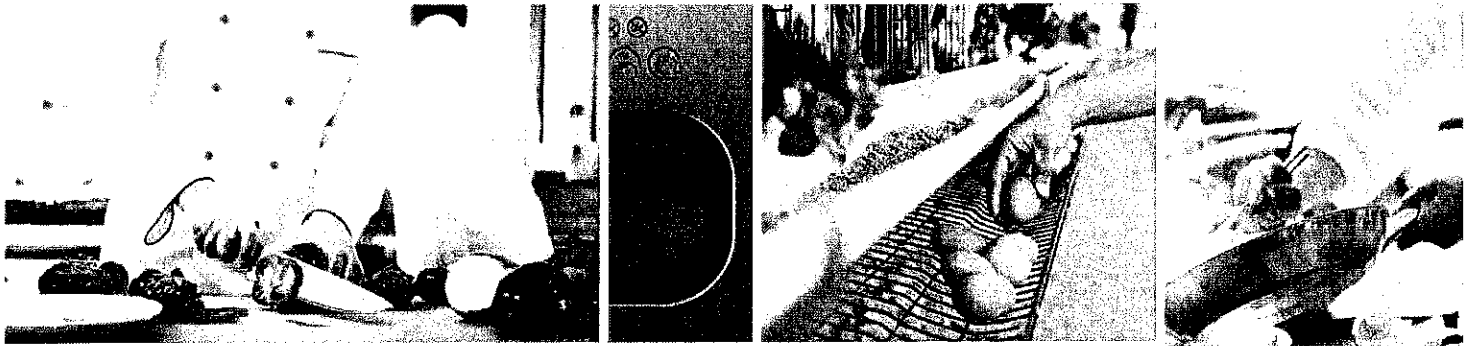


## STERIPOWER AZ ÉLELMISZERIPARBAN



Mindenki, aki feldolgozott vagy feldolgozatlan élelmiszerrel dolgozik, tudja milyen kockázat és felelősség van a kezében. Az élelmiszerrel való munka egy nagyon érzékeny terület, számtalan érintkezési pont van, ahol a fertőzés lehetséges.

Ezért, az élelmiszerrel dolgozóknak különösen oda kell figyelniük a kéz higiéniára - biztosítani kell nekik további fertőtlenítési lehetőséget, - ami kezeik egészségeseen tartásához szükséges -, erre kínál ideális megoldást a Steripower. A Steripower Picco 500 rozsdamentes acélból az újratölthető akkumulátorával elég kicsi ahhoz, hogy bárhova odahelyezzük, ahová szükséges.

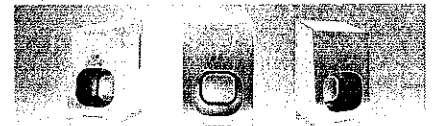


### A Steripower kiemelt jellemzői élelmiszeripar számára

- rozsdamentes acél
- kicsi és könnyű- bárhová helyezhető
- érintésmentes adagolási rendszer
- bármely fertőtlenítő oldattal kompatibilis
- újratölthető akkumulátorral vagy állandó áram ellátással


### Javaslatok Steripower készülékek használatáról élelmiszeriparban

- PW-10100 Steripower fehér állandó áramellátással  
 PW-40010 Picco 500, rozsdamentes acél, akkumulátorral

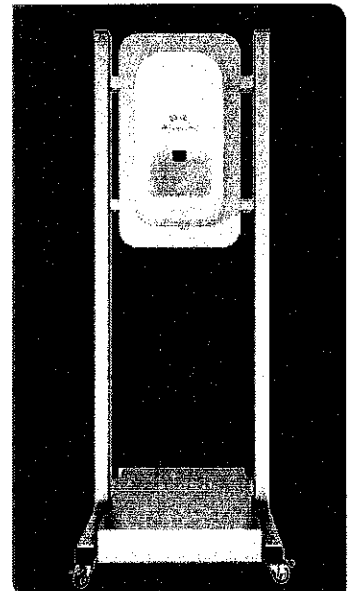


schülke →



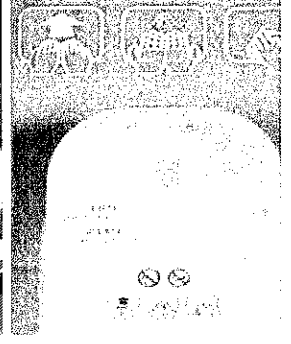

## STERIPOWER AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN

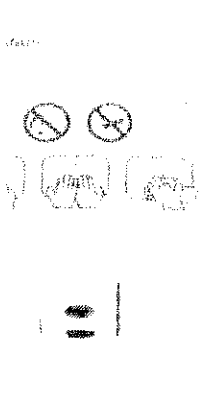

A fertőző járványok az egyik fő oka az elmulasztott iskolai napok milliónak. Egy csoportos tér, mint pl. az óvodák és iskolák, a fertőzések átvitelének a tökéletes környezete, mert mindenki megosztja a játékait, készleteit és felszerelését egymással. Számos módja van a fertőzések terjedésének megelőzésére, közülük az egyik a gyerekek helyes kéz higiénés gyakorlatának megtanítása. A tanárok ezen speciális feladatának támogatásául a Steripower kifejlesztett egy fertőtlenítő készüléket biztonsági fény funkcióval, ami egy programozható chippel nyitható zár.

### A Steripower kiemelt jellemzői óvodák és iskolák számára

- biztonsági fény funkció
- egyedi megoldás
- állítható adagolás (a fertőtlenítőszer adagolás állítható 0,5-5ml-ig)
- bármilyen gyermekek számára is használható fertőtlenítő oldattal



### Steripower Speciál

egyedi megoldásokat kínálunk- iskolák és óvodák számára egy olyan állványt ajánlunk, amely állítható magasságú. A biztonsági fény beépítésével meggyőződhetünk róla, hogy a gyerekek csak a tanárok felügyelete alatt használhatják.



Az állvány monitorral együtt is választható, amelyen speciális információk futtathatók, mint például hogyan mossunk kezet, mikor fertőtlenítsük, ... stb.

### Javaslatok Steripower készülékek használatáról óvodák és iskolákszáma


PW-10120 Steripower fehér, biztonsági fénnel.

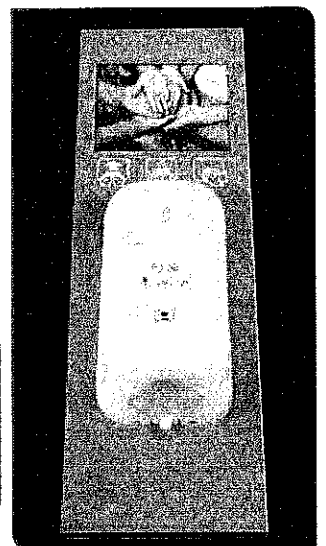

schülke -†

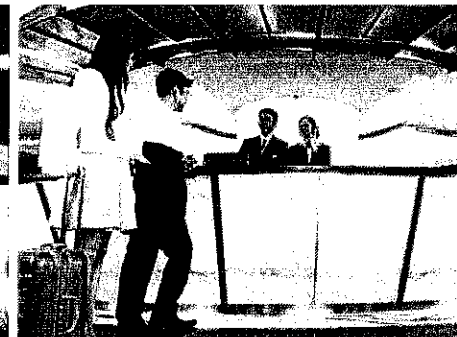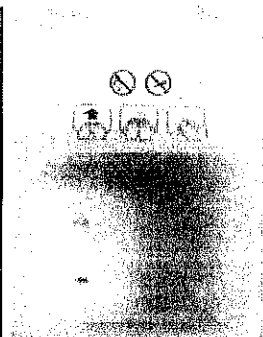

## STERIPOWER A VÁLLALATOKNÁL

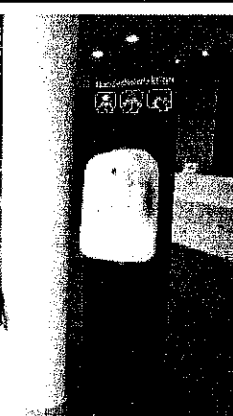

Megfázás, influenza, fejfájás és gyomorfájás csak egy kevés része a lehetséges következményeknek, amikor sok, különböző egyéni higiénés szokásokkal rendelkező ember használja ugyanazt az ajtót, lift gombot, vagy tárgyalót. Néhány tanulmány még azt is megmutatta, hogy a munka terek gyakran erősebben szennyezettek kórokozók által, mint a wc ülések. Az irodákban vagy vendéglátóiparban lévő alacsony higiénia, a dolgozók megbetegedési arányának- és az elégedetlenség megnövekedéséhez vezet.

Számos módja létezik az általános irodai és vendéglátóipari higiéniai szintnek a növelésére. A Steripower az egyiket kínálja ezek közül- a stílusos, érintésmentes fertőtlenítő készülék modern, testre szabott módon biztosítja a kézhigiénia elősegítését nyilvános helyeken.

A Steripower kiemelt jellemzői üzleti- és vendéglátóipari felhasználásra

- érintésmentes adagoló rendszer
- testre szabott megoldás- Steripower készülék a céges design szerint
- újratölthető akkumulátor- bárhol használható a készülék
- fontos információknak kijelző, hirdetés vagy időjárás előrejelzés

Javaslatok Steripower készülékek használatáról üzleti- és vendéglátóipari felhasználásra

- PW-10040 Steripower fehér, akkumulátorral  
PW-10100 Steripower fehér, állandó áram ellátással.



schülke -+



# Steripower

## Érintésmentes kézfertőtlenítő egység

### Hálózati vagy újratölthető elemmel felszerelt

- Flexibilis pozicionálás az újratölthető elemeknek köszönhetően.
- A készenléti idő a használat mértékétől függ.
- Optikai jelzés, mielőtt kezdene lemerülni

### Érzékelő

- A szenzor egy beállított mennyiséget adagol

### Széles nyílás

- Mindkét kéz egy időben történő érintésmentes fertőtlenítése.
- A többlet folyadék nem károsítja a padlót vagy a munkafelületet

### DIN szabványú töltési csatlakozó

- Csatlakozás a zárt hálózati töltővel (cikkszám 10041)

### Jelzés

- Opcionális kapcsolat pl. az automata ajtó nyitással

### Adagolás

- Felhasználás specifikus adagolási átláthatóság 10 szintben 0,5 ml-től 5 ml-ig.

### Kompatibilitás

- Minden ismert fertőtlenítő folyadékkal használható (500 ml és 1 literes flakonok)

### Permetezés

- Mindkét kezet egyenlő mértékben borítja be fertőtlenítő folyadékkal

### Csepegtető tálca

- Felszívó paddal ellátott.
- A többlet folyadék mennyiséget elvezeti és elzárja



### Méretek

- magasság: 505 mm
- szélesség: 290 mm
- mélység: 200 mm

### Opcionális: Számláló

- Digitális számláló az adagolás és a mennyiség ellenőrzése céljából

Nem igényel karbantartást!

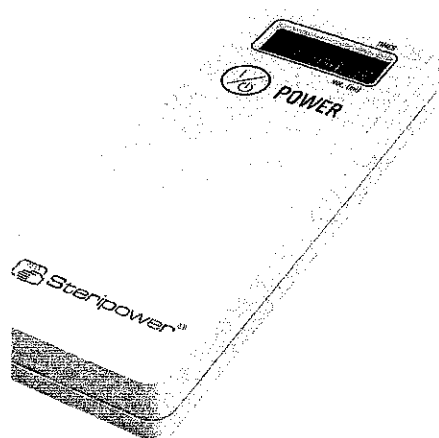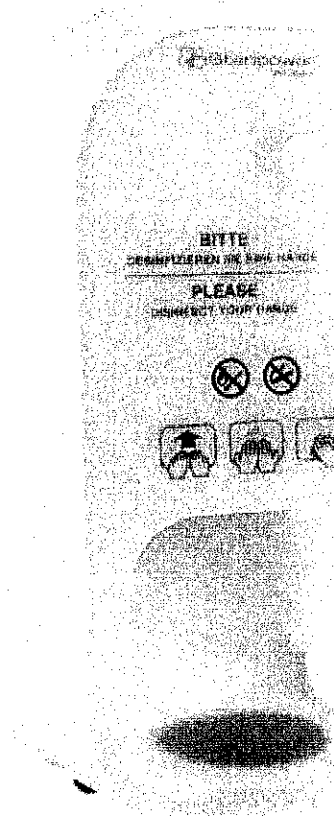

schülke →

# Steripower

## Picco 500

### Akkumulátoros működés

- Működtetés újratölthető akkumulátorral
- Rugalmas pozicionálás
- A készenléti ideje a használatától függ

### Szenzor

- A szenzor a beállított mennyiségből egy felhasználásra valót adagol

### Széles nyílás

- Mindkét kéz egyidejű érintésmentes fertőtlenítésére. A felesleges folyadék ezáltal nem tudja a padlót, vagy a munkafelületet károsítani.

### Variálható / változtatható

- Használható asztali-, álló- vagy fali adagolóként

### Jelzés

- Opcionális kapcsolat például az automata ajtónyitóval, forgó permetezővel, vagy más bejutást irányítóval

### Adagolás

- Alkalmazási adagolás állítása 10 szintben, 0,5 ml-től 5 ml-ig


### Kompatibilitás

- Minden ismert fertőtlenítő folyadékkal használható (Géllel nem!, maximum 500 ml-es flakonokkal)

### Permetezés

- A tenyeret egyenletesen befedi fertőtlenítőszerezrel

**Nem igényel karbantartást!**


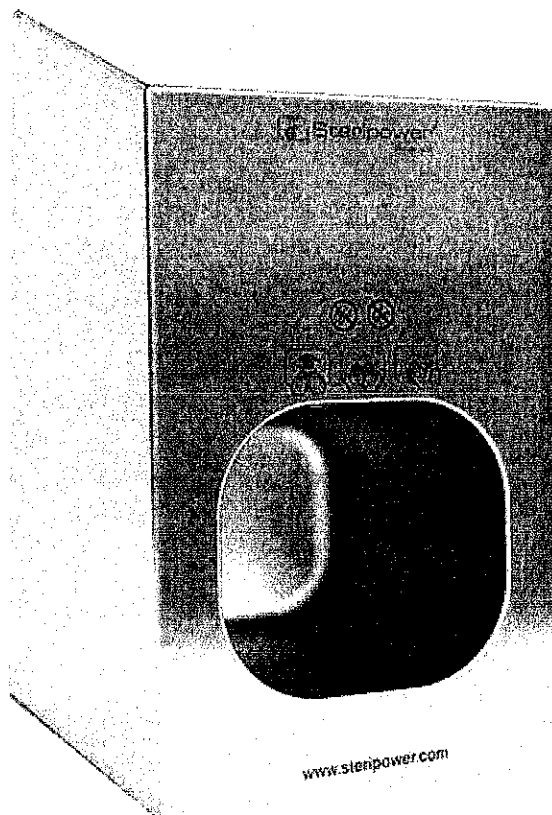


### Csepegtető tálca

- Nedszívó párnával
- A felesleges folyadékot magába zárja

### Méretek

- magasság: 377 mm
- szélesség: 215 mm
- mélység: 165 mm

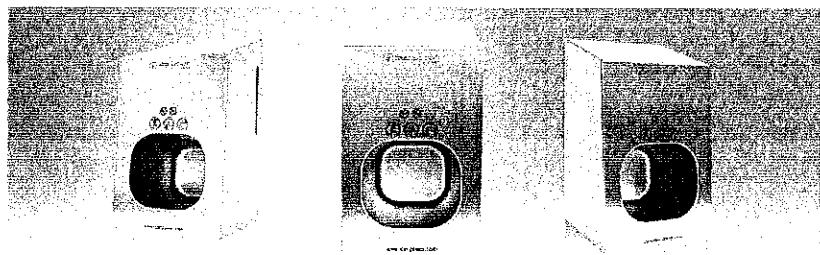

**schülke** →

# Steripower

## Mini 500

### Újratölthető akkumulátor

- Az újratölthető akkumulátorról történő működtetés készenléti ideje körülbelül 6 hét vagy 2500 alkalom, ezáltal rugalmas a pozícionálása

### Kompatibilitás

- Minden ismert fertőtlenítő folyadékkal használható ( maximum 500 ml-es flakonokkal)

### Megfigyelő ablak

- A folyadékszint ellenőrzésére

### Szenzor

- A kezet az egység alá mozdítva a szenzor egy felhasználásra valót bocsát ki a választott adagolásból

### Permetezés

- A kezet egyenletesen befedi fertőtlenítőszer folyadékkal. Nem porlasztja, ezáltal nincsenek aeroszol gőzök


### Zárható

- Opcionális : Az egység zárható.

### Adagolás

- Alkalmazási adagolás állítása 10 szintben, 0,5 ml-től 5 ml-ig

**Nem igényel karbantartást!**

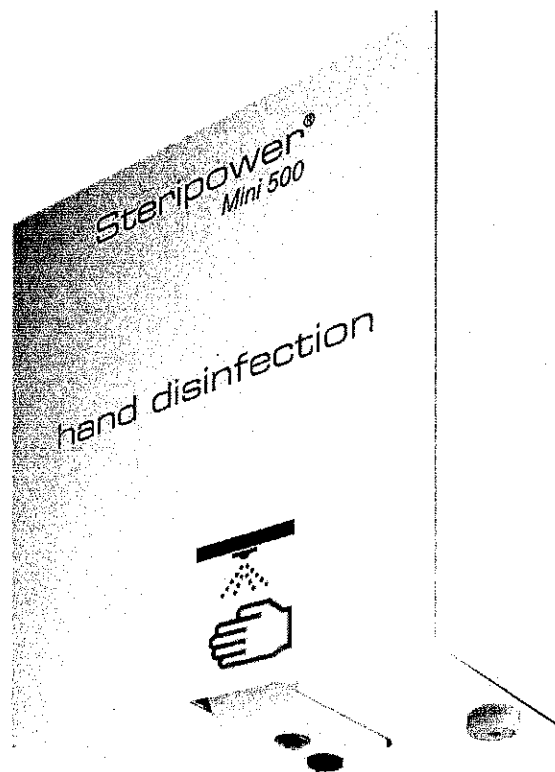


### Méretek


- magasság: 197 mm
- szélesség: 182 mm
- mélység: 100 mm




**schülke + sohn**

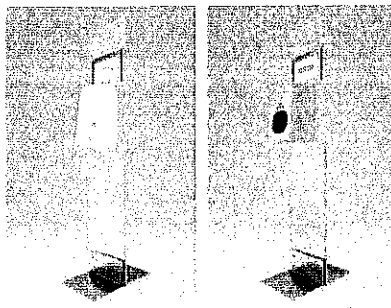


80162 Steripower  
80163 Picco500  
Akril világító  
tábla PC

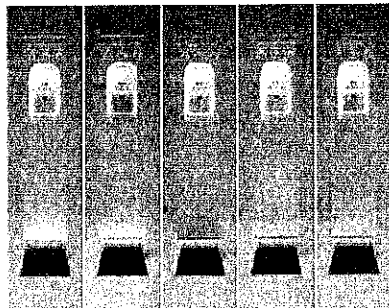


80160  
Steripower vagy Picco500  
Megvilágított akril



80140 Steripower  
80141 Picco500  
Akrill

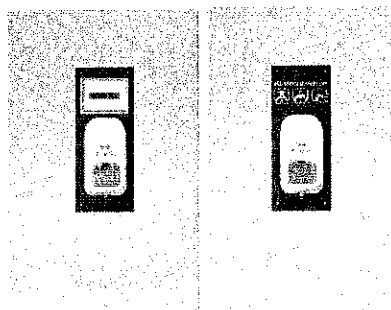


80178 Fa, műanyag bevonattal, csuklós  
80179 váz

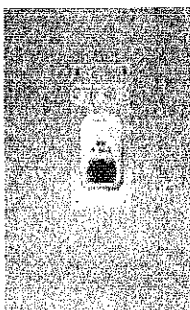

80181 Fali kivitel, akril opcionálisan  
80170 megvilágított  
Steripower vagy Picco500




80112 RAL 9006  
80111 RAL 7016  
Aluminium fehér Antracid  
Fa, műanyag bevonattal

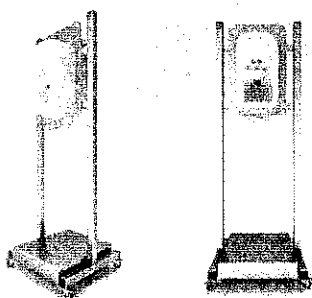

80130 Rozsdamentes acél (CNS)  
Opcionális: 5 literes kanna



80401 - 08 Steripower  
80501 - 08 Picco500  
Fali panel, különböző színekben

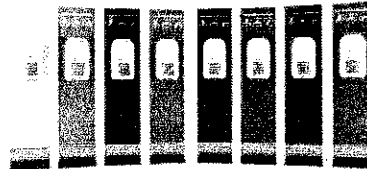

80301 - 08 Steripower  
Különböző színekben

Minden itt bemutatott állványt és tartót készülék nélkül szállítunk!